

*Prüfen Sie Ihre Netze  
mit den  
VIRAX-Pumpen!*



Präzision, kompakter Aufbau und Schnelligkeit für Ihre Dichtigkeitstests.

 **virax**



**Leichter Transport** der Prüfpumpe dank eines Blockiermechanismus des Hebels.

MANUELLE PRÜFPUMPE     ELEKTRISCHE PRÜFPUMPE

Pumpen, Testen und Entleeren mit **einem einzigen Knopf**.

MANUELLE PRÜFPUMPE     ELEKTRISCHE PRÜFPUMPE

## Manuelle Prüfpumpen

Praktisch und leicht, zum Durchführen Ihrer Dichtigkeitstests!



Teil-Nr.262005



Teil-Nr.262015



Teil-Nr.262035

### Serienausstattung:

#### Kunststofftank:

- Stoßfest und leicht.
- Reduzierte Maße für beschränkten Platz.

#### Langer Schlauch (1,50 m):

- Praktischer Einsatz.

#### Hochpräzises Manometer:

- Genaue Ergebnisse mit einem Manometer der Klasse 1.6.
- Leichtes Ablesen mit Einteilung 1 bar.





**Schnelles Arbeiten** dank  
des Durchflusses von 6 l/min

- MANUELLE PRÜFPUMPE     ELEKTRISCHE PRÜFPUMPE



**Unabhängig bleiben:** Ansaugen aus  
einem äußeren Behälter, wenn kein  
Wasseranschluss verfügbar ist.

- MANUELLE PRÜFPUMPE     ELEKTRISCHE PRÜFPUMPE

## Elektrische Prüfpumpe

Für die Dichtigkeitskontrolle in Rohrleitungen und  
Behältern bis zu 40 bar.

NEW  
RELEASE  
virax



Teil-Nr.262070



### Serienausstattung:

**Solider Aufbau aus ABS mit Transportgriff.**

- Stoßfest.

**Geschütztes Glyzerinmanometer:**

- Kompensiert Druckstöße und Vibrationen.
- Ermöglicht leichtes Ablesen.
- Skala in bar, psi und MPa.

**Selbstansaugend auf 1 m Höhe:**

- Ein Wasseranschluss ist nicht notwendig.

**Vereinfachte Inbetriebnahme:**

- Dank der direkt am Produkt lesbaren Gebrauchsanleitung.



 **virax**




Manometer 50 bar



Manometer 100 bar



Glyzerinmanometer

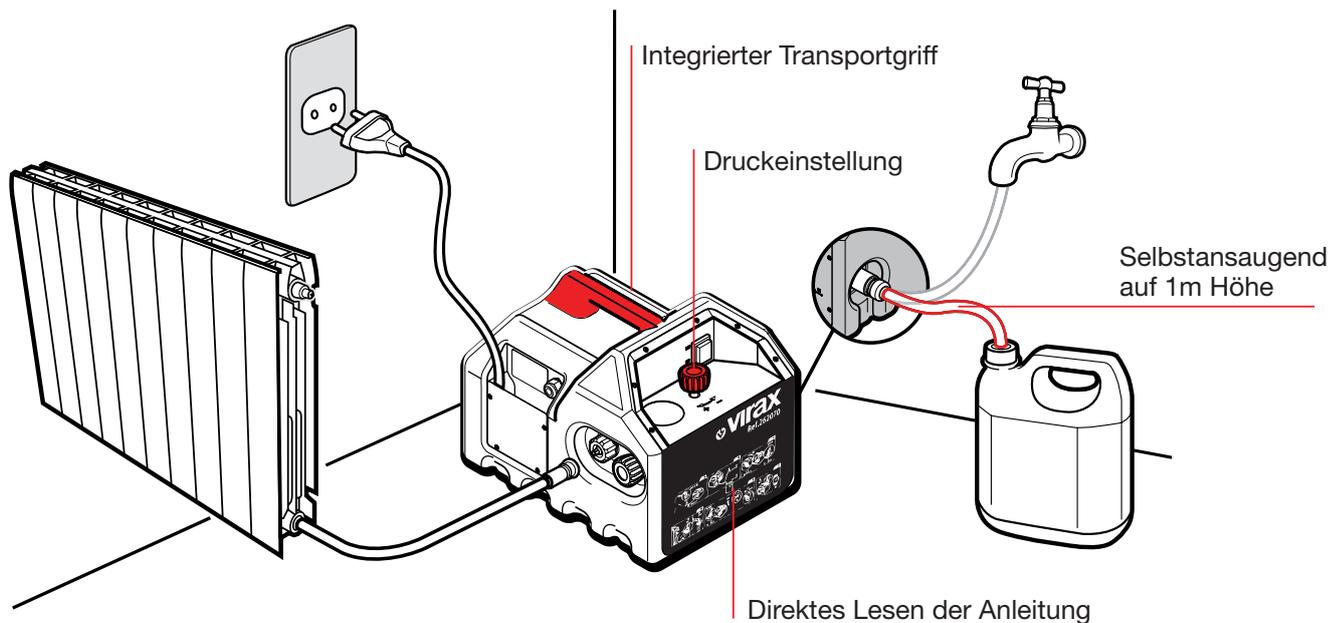

## Technische Daten

Beschreibung	Manuell/ Elektrisch	Tankka- pazität (l)	Maximaler Druck (bar)	Gelieferte Anschlüsse	Zuge- lassene Flüssig- keiten	Gelieferter Hochdruck- schlauch	Gelieferter Wasser- anschluss- schlauch	Teil-Nr.
Hochdruck-Prüfpumpe	Manuell	10	100	3/8" und 1/2"	Wasser, Öl, Glykol*	1,50 m	-	262005
Prüfpumpe großen Volumens	Manuell	10	50				-	262015
Kompakte Prüfpumpe	Manuell	5	50				-	262035
Elektrische Prüfpumpe	Elektrisch	-	40	1/2		1,20 m	1,30 m	262070

\*Nach Gebrauch Spülen erforderlich.

## Zubehör

Beschreibung	Für	Teil-Nr.
Manometer 50 bar mit Eichzertifikat	262015/262035	753447
Manometer 100 bar mit Eichzertifikat	262005	753448
Hochpräzisions-Manometer - 15 bar, Skala 0,5 bar	262015/262035	753449

Getrennt geliefertes und durch den Benutzer zu montierendes Zubehör.

[www.virax.com](http://www.virax.com)

VIRAX France : [client.fr@virax.com](mailto:client.fr@virax.com)  
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International: [export@virax.com](mailto:export@virax.com)  
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70

